



GWF MessSysteme AG

Obergrundstrasse 119
 CH-6002 Luzern Schweiz
 Telefon ++41/41-319 50 50
 Telefax ++41/41-310 60 87
 E-Mail gwf@gwf.ch


TC-M20

SE 09 31_V1.0_D

gezeichnet: 16.10.2001 thb
 geändert: 26.08.2009 asi

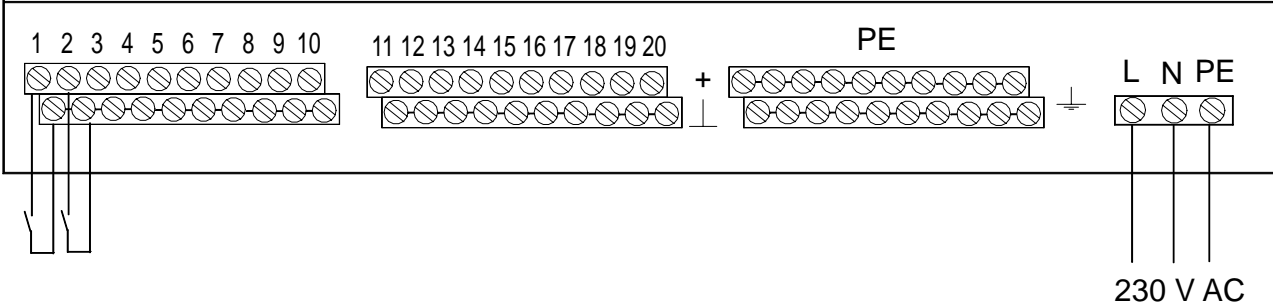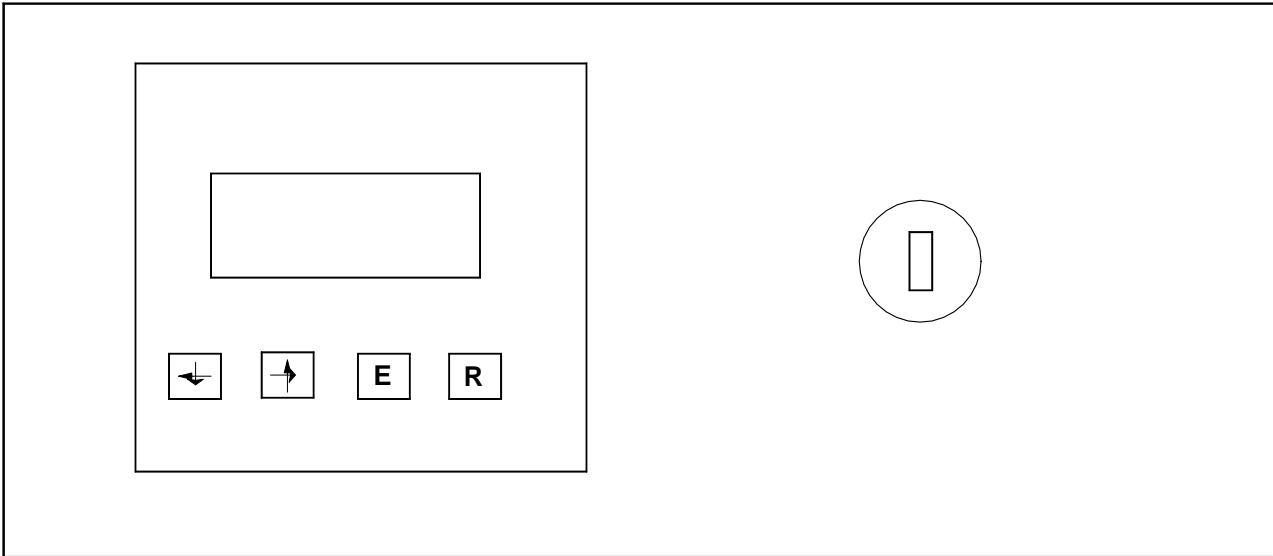

- Reedkontakt polaritätsunabhängig
- Bei open collector Polung beachten (gemäss Abb.)

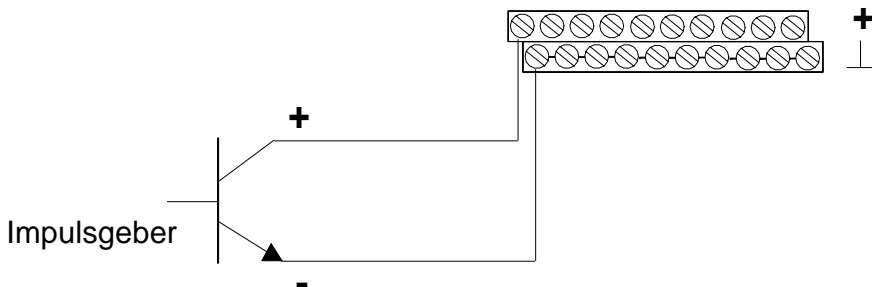

max. 5 Hz
 Strom ca. 8-10mA
 Abfragespannung 5V DC